



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zadavatele	AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo	Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
IČ	27376184
DIČ	CZ27376184
Spisová značka	B 3040 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Profil zadavatele	https://profily.proebiz.com/profile/27376184
Internetová adresa zadavatele	https://alinvest.cz/

Kontaktní osoba zadávacího řízení	Ing. Helena Strusková
Tel	+420 720 846 635
Email	helena.struskova@alinvest.cz


Název veřejné zakázky	ALFAGEN - VYBAVENÍ METALOGRAFICKÉ LABORATOŘE
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2026-004662
Systémové číslo JOSEPHINE	73587

V souladu s kap. 14 Zadávací dokumentace zadavatel tímto sděluje vysvětlení Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky:

Žádost účastníka o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Naše technické řešení umožňuje přípravu vzorků od průměru 20 mm až do průměru 125 mm o výšce vzorků až 50 mm.

Vzorky do průměru 70 mm včetně se budou připravovat vcelku a vzorky o průměru 70–125 mm se budou připravovat tak, že se nejprve rozřežou na dvě poloviny (1 rychlý řez) a poté se budou brousit a leštit

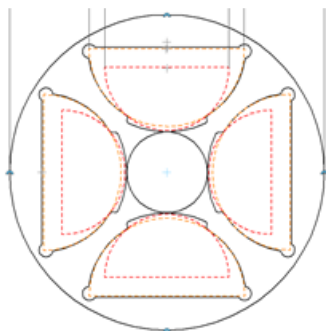

Výhody tohoto řešení:

- vyšší produktivita práce, vzorky do průměru 105 mm lze připravit 2ks vzorků v jednom držáku vzorků, tj. dva vzorky za cca 30-35 min.
- Výrazně vyšší životnost stroje – nevznikají vibrace, ve srovnání, když by se velké vzorky (větší než 70 mm) připravovali vcelku.
- Vyšší životnost spotřebních materiálů, protože se využívá celá plocha brusných/leštících disků
- Výrazně nižší provozní náklady

Prosíme o potvrzení, zda toto řešení vyhovuje.

Vysvětlení zadavatele

Navrhované řešení je v souladu s technickým zadáním této veřejné zakázky.

Žádost účastníka o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

V technické specifikaci je uvedena stolní pila. Je možné dodat pilu podlahovou (samostojnou)? Dodávka větší pily neovlivní cenu za celkové dílo díky úsporám, které jsme docílili v konstrukčním řešení robotické brusky. Cena za celkové dílo by stále odpovídala zhruba ceně posledního návrhu našeho technického řešení. Tato změna by měla celou řadu výhod viz níže:

Výhody tohoto řešení:

- Stejně funkce, jen podlahová pila je výrazně robustnější.
- Větší řezná komora a větší automatický pracovní stůl.
- Větší prořez až do průměru 150 mm.
- Možnost zcela automaticky řezat větší počet vzorků současně (min 1x více než u stolního modelu (až 12 vzorků oproti 6 u stolní verzi)).
- 3x větší recirkulační jednotka 130 l s výkonnější filtrací je výrazně méně náročná na údržbu s nižší frekvencí čištění.
- Oproti stolní pile je zde automatické mazání.
- Budou se dělit vzorky větší než průměr 70 mm na dvě poloviny ve velkém množství, větší pila představuje větší stabilitu procesu v třisměnném provozu s menšími nároky na údržbu.
- Velikostně je tato pila přibližně stejně velká jako stolní pila se stolem.

Naše navrhované řešení oproti řešení poptávaném v zadávací dokumentaci více zohledňuje požadavek na provozní charakter pracoviště a přípravu nadstandardně vysokého množství vzorků.

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel trvá na požadavku dodání pily dle specifikace uvedené v příloze č. 3 Zadávací dokumentace - Technické zadání.

Žádost účastníka o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

V technické specifikaci se požaduje dodat veškerý nábytek z kovu včetně skříně a středového pultu.

Jelikož tyto dvě položky (skříň a středový pult) nejsou standardizované, budou se vyrábět na zakázku, nebudou na nich stroje a nebudou nějak extra zatěžované, je možné je dodat s touto konstrukcí:

Skříň na spotřební a pomocný materiál – materiál robustní konstrukce z lamina

Středový pult umístěný ve volném prostoru, využitý jako pracovní plocha

- konstrukce - kovové nosníky opláštěny laminem
- pracovní deska – z vysokotlakého laminátu – stejná jako u ostatních kovových stolů
- vestavba polic a skříněk z lamina

Vysvětlení zadavatele

Ano, navrhované řešení je v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 3 Zadávací dokumentace - Technické zadání (v této podrobnosti nebyl požadavek v rámci přílohy č. 3 Zadávací dokumentace - Technické zadání detailně specifikován).

Žádost účastníka o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4

U středového pultu umístěný ve volném prostoru, využitý jako pracovní plocha se požaduje šířka stolu nejméně 800 mm – jelikož 800 mm nemá ani samotná místnost, tak předpokládám, že se jedná o chybu a správně je 800 mm. Je tomu tak?

Vysvětlení zadavatele

Ano, jedná se o chybu v psaní (překlep). Vzhledem k avizované velikosti metalografické laboratoře (6,72 x 5,45 m) se v případě položky „*Středový pult umístěný ve volném prostoru, využitý jako pracovní plocha*“ skutečně jedná o požadavek na šířku stolu nejméně 800 mm.

V _____ Břidličné _____ dne 12. 02. 2026