



Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2025-24-NZ-POO

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 3

podľa § 53 v nadv. na § 66 ods. 7 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Predmet zákazky :	Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
Vyhlasenie verejného obstarávania :	Ú. v. EÚ OJ S 59/2025 č. 190739-2025 zo dňa 25.3.2025 VVO č. 174/2025 zo dňa 26.3.2025 pod označením 5689 - MST
Postup verejného obstarávania:	verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO
Zákazka z hľadiska limitu:	nadlimitná zákazka
Predkladanie ponúk:	elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote do 14.05.2025 do 12:00:00 hod.
Druh zákazky:	tovar
Miesto konania :	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Termín otvárania ponúk:	14.05.2025 o 12:30 hod.
Názov projektu:	Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj 128 slice – Rastislavova 43
Kód projektu:	11/02-21-V11-000171

I. Členovia komisie v zmysle § 51 ZVO v priebehu procesu hodnotenia ponúk a vykonaných zmien v zložení komisie:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. MUDr. Henrieta Blašková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 2. MUDr. Ľubomír Demský | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 3. MUDr. Vincent Greššák | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 4. MUDr. Alena Rolková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 5. Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M | - člen bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant verejného obstarávania od 27.8.2025 |

II. Hodnotenie ponúk:

Verejnému obstarávateľovi bolo z Úradu pre verejné obstarávanie doručené **rozhodnutie** č. 10176-6000/2025, zo dňa 17.9.2025 vo veci námietok uchádzača MEDITRADE spol. s r. o., Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001 (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „uchádzač“), smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti vylúčeniu z verejnej súťaže na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00 606 707 (ďalej len „kontrolovaný“ alebo „verejný obstarávateľ“) v Úradnom vestníku Európskej únie série S č. 59/2025 zo dňa 25. 03. 2025 pod číslom 190739-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2025 zo dňa 26. 03. 2025 pod číslom 5689-MST (ďalej len „verejná súťaž“), v ktorom Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00 606 707 vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie série S č. 59/2025 zo dňa 25. 03. 2025 pod číslom 190739-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2025 zo dňa 26. 03. 2025 pod číslom 5689-MST, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa označené ako „Vylúčenie ponuky“ zo dňa 04. 07. 2025 doručené navrhovateľovi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE dňa 04. 07. 2025, zaradiť ponuku navrhovateľa späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť ponuku navrhovateľa z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky - technický parameter č. 4 „Rýchlosť chladenia anódy väčšie alebo rovné 1,38 MHU/min“, a to do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného bola navrhovateľovi dňa 23.9.2025 doručená informácia o zrušení rozhodnutia verejného obstarávateľa o vylúčení ponuky.

Následne komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí po vyhodnotení kritérií.

Uchádzačovi MEDITRADE spol. s r. o., Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001 bola dňa 10.10.2025 doručená žiadosť o vysvetlenie ponuky ohľadne splnenia požiadaviek na predmet zákazky, v znení:

„Spoločnosť **MEDITRADE spol. s r. o.**, so sídlom **Levočská 1, 851 01 Bratislava** (ďalej len „uchádzač“) predložila ponuku v rámci verejného obstarávania na predmet **„Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM“**, zverejneného formou Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ dňa 25.03.2025, pod označením 190739-2025, a vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2025, dňa 26.03.2025, pod označením 5689 – MST.

Verejný obstarávateľ v rámci prílohy č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov požadoval nasledovné parametre:

Parameter č. 20 technickej špecifikácie:

„Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z, v klinickom režime s možnosťou kontinuálnej špirálovej akvizície bez prerušenia – väčší alebo rovný 200 cm.“

Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že požadovaný parameter je preukázaný v dokumente „Apex Elite PDS“. Po kontrole predložených dokumentov verejný obstarávateľ zistil, že súbor s uvedeným názvom nebol v rámci ponuky predložený. Na základe prehlídnutia dostupných dokumentov verejný obstarávateľ dospel k záveru, že uchádzač mal pravdepodobne na mysli dokument s názvom „Prospekt_Revolution Apex Elite“.

V predmetnom dokumente „Prospekt_Revolution Apex Elite“ je na strane 9 uvedený údaj „Horizontálny rozsah skenovania (bez kovu) až 2000 mm“, avšak nie je v ňom jednoznačne špecifikované, že sa tento rozsah vzťahuje na špirálový skenovací režim v klinickom režime bez prerušenia.

Z dôvodu nejasnosti uvedeného parametra verejný obstarávateľ overoval technické údaje aj z verejne dostupných zdrojov. Na stránke oficiálneho výrobcu ponúkaného prístroja (GE Healthcare) bol identifikovaný dokument:

„Revolution Apex, Revolution CT with Apex edition – User Manual, Apex 3.0“, dostupný na webovej stránke výrobcu: https://www.gehealthcare.com/support/manuals?srltid=AfmBQoq3Ysdm_OF2IFNdVuClxzHApppYjlulc0zWefortOdRrZn2NVA&search=eyJzZWZyY2h0UZXJtjoiNTk1MTc1MC0xRU4iLCJ5YW5ndWFnZU5hbWUiOiJFbmdsaXNoIChFTikifQ%3D%3D

Podľa uvedeného manuálu sú na strane 979/1048, v kapitole 23.3.2 Patient Scanning, uvedené maximálne dĺžky skenovania pre jednotlivé typy patientskych stolov v rôznych skenovacích režimoch. Na základe údajov predložených uchádzačom ponúkané zariadenie j vybavené stolom NG2000SV Table. V uvedenom manuáli výrobcu je pre tento typ stola pri špirálovom skenovanom režime uvedený maximálny skenovací rozsah 1850 mm.

23.3.2 Patient Scanning

Table 23-3 Table Scan Length

Scan	Scan Length (mm)				
	NG2000 Table	NG2000V Table	NG1700V Table	NG2000SV Table	NG1700SV Table
Scout Scans	2000 mm	2000 mm	1700 mm	2000 mm	1700 mm
Axial/Cardiac Scans	2000 mm	2000 mm	1700 mm	2000 mm	1700 mm
Helical Scans	1850 mm	1850 mm	1550 mm	1850 mm	1550 mm

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ žiada uchádzača o vysvetlenie:

Žiadame o jasné a jednoznačné vysvetlenie, aký horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z, v klinickom režime s možnosťou kontinuálnej špirálovej akvizície bez prerušenia disponuje ponúkané zariadenie Revolution Apex Elite.

Zároveň verejný obstarávateľ žiada uchádzača o relevantné dokázanie oficiálnym data sheetom priamo od výrobcu daného zariadenia, že ponúkaný systém je technicky schopný dosiahnuť požadovaný horizontálny skenovací rozsah špirálovým nepretržitým skenovaním ≥ 200 cm v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v prílohe č. 6 Špecifikácie predmetu zákazky.

V rámci vysvetlenia ďalej žiadame uchádzača, aby sa vyjadril k zistenej nezhode medzi údajmi uvedenými v dokumentoch predložených v ponuke a údajmi uvedenými v oficiálnych dokumentoch výrobcu (User Manual – Revolution Apex, Revolution CT with Apex edition, Apex 3.0), kde je pre typ stola NG2000SV Table uvedený maximálny rozsah pri špirálovej akvizícii 1850 mm.

Parameter č. 30 technickej špecifikácie – Rozsah vyšetrenia dynamickej 4D CT angiografie: 50 cm

V rámci predloženej technickej špecifikácie uchádzač uviedol, že daný parameter je možné dohľadať v dokumente „Apex Elite PDS“ (Prospekt_Revolution Apex Elite), avšak neuviedol konkrétnu stranu, na ktorej je uvedený údaj o rozsahu vyšetrenia dynamickej 4D CT angiografie. Po preskúmaní predloženého dokumentu verejný obstarávateľ nenašiel žiadnu informáciu, ktorá by potvrdzovala deklarovaný rozsah 50 cm pre dynamickú 4D CT angiografiu.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ preveril aj verejne dostupné technické informácie od oficiálneho výrobcu zariadenia, konkrétne v dokumente:

„Revolution Apex, Revolution CT with Apex edition – User Manual, Apex 3.0“, dostupnom na webovej stránke výrobcu:

https://www.gehealthcare.com/support/manuals?srsId=AfmBOoq3Ysdm_OF2IFNdVuClxzHApppYilulc0zWefcrtOdRrzn2NVA&search=eyJzZWYyY2hUZXJtIjoINtK1MTc1MC0xRU4iLCJsYW5ndWFnZU5hbWUiOiJFbmdsaXNoIChFTikifQ%3D%3D

V uvedenom manuáli sa na strane 550/1048 nachádza popis funkcie „Shuttle Mode Imaging“, ktorá umožňuje rozšírenie pozdĺžneho (longitudinálneho) rozsahu skenovania pomocou opakovaného posunu pacienta počas vyšetrenia. Táto funkcia – označená ako VolumeShuttle (Axial) – rozširuje rozsah perfúzneho a dynamického CT angiografického pokrytia nad rámec bežného cine režimu, pričom podľa manuálu sa pri cine režime maximálny rozsah skenovania uvádza ako 160 mm, čiže maximálna šírka detektora (str. 290/1048).

Parametre č. 21 a 25 technickej špecifikácie:

Ad 21: „Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní“

Uchádzač vo svojej ponuke uviedol 437 mm/s.

Ad 25: „Rýchlosť pohybu vyšetrovacieho stola“

Uchádzač vo svojej ponuke uviedol 300 mm/s.

Nie je možné dosiahnuť rýchlosť skenovania 437 mm/s s posunom stola s rýchlosťou 300 mm/s s detektorom o šírke 160 mm.

Z dôvodu nejasnosti uvedených parametrov verejný obstarávateľ overoval technické údaje aj z verejne dostupných zdrojov. Na stránke oficiálneho výrobcu ponúkaného prístroja (GE Healthcare) bol identifikovaný dokument: „Revolution Apex, Revolution CT with Apex edition – User Manual, Apex 3.0“, dostupný na webovej stránke výrobcu: https://www.gehealthcare.com/support/manuals?srsId=AfmBOoq3Ysdm_OF2IFNdVuClxzHApppYilulc0zWefcrtOdRrzn2NVA&search=eyJzZWYyY2hUZXJtIjoINtK1MTc1MC0xRU4iLCJsYW5ndWFnZU5hbWUiOiJFbmdsaXNoIChFTikifQ%3D%3D

V dokumente nie je uvedená rýchlosť špirálového skenovania, iba možnosť HyperDrive s vyšším pitch faktorom, bez uvedenia rýchlosti.

Preto žiadame potvrdenie priamo od výrobcu, že je možné dosiahnuť rýchlosť skenovania 437 mm/s.

Rovnako žiadame vysvetlenie, či je v ponuke zahrnutá položka HyperDrive.

Verejným obstarávateľom požadované doplnené doklady/dokumenty v rámci vysvetlenia ponuky je potrebné predložiť do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, prostredníctvom komunikácie systému Josephine.“

Uchádzač v lehote určenej komisiou verejného obstarávateľa, dňa 17.10.2025 predložil vysvetlenie ponuky. Komisia následne pokračovala vo vyhodnotení ponuky.

Uchádzač doručil písomné vysvetlenie ponuky a doručil tiež dokumenty:

- dokument Manufacturer confirmation (potvrdenie výrobcu)
- prospekt Revolution Apex Elite (špecifikácia produktu v slovenskom jazyku)
- prospekt Revolution Apex Elite (špecifikácia produktu v anglickom jazyku)

Komisia zriadená verejným obstarávateľom k predmetnému verejnému obstarávaniu posúdila uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky a dospela k záverom, ktoré boli predmetom druhej žiadosti o vysvetlenie ponuky, doručenej uchádzačovi dňa 10.11.2025, v znení:

„Po preštudovaní vysvetlenia komisia konštatuje, že aj napriek doplneným dokumentom nebolo jednoznačne preukázané, že ponúkané zariadenie GE Revolution Apex Elite spĺňa požadované technické parametre.

- Z predloženého potvrdenia výrobcu vyplýva, že dokument nevydal priamy výrobca zariadenia, ale európsky zástupca výrobcu. Z tohto dôvodu nemožno predložený dokument považovať za oficiálne potvrdenie výrobcu v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač v rámci predchádzajúcej komunikácie nepredložil požadované DICOM výstupy alebo iné objektívne merateľné technické dôkazy, z ktorých by bolo možné jednoznačne overiť splnenie uvedeného parametra v klinickom režime.

- Predložené potvrdenie, ktoré navyše nepochádza od samotného výrobcu, nie je dostatočným dôkazom o technickej zhode ponúkaného systému s požiadavkami obstarávateľa.

- Argumentácia uchádzača, podľa ktorej má „vyhlásenie výrobcu“ vyššiu dôkaznú hodnotu ako produktový datasheet, nie je relevantná, keďže v danom prípade nie je preukázané, že dokument vydal priamy výrobca zariadenia. Naopak, oficiálny produktový datasheet predstavuje štandardizovaný technický dokument výrobcu, ktorý obsahuje overené a certifikované technické údaje a ako taký je všeobecne uznávaný ako primárny zdroj technických špecifikácií výrobku.

Na základe vyššie uvedeného komisia konštatuje, že predložené vysvetlenie ponuky neodstraňuje pochybnosti o splnení požadovaných parametrov, keďže:

- nebolo doložené oficiálne potvrdenie od samotného výrobcu zariadenia
- neboli predložené žiadne merateľné výstupy alebo dôkazy o splnení daných parametrov
- neboli zodpovedané všetky otázky v rámci žiadosti o vysvetlenie

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ považuje vysvetlenie uchádzača za nedostatočné a pôvodnú pochybnosť o splnení sporných technických parametrov za pretrvávajúcu. Preto verejný obstarávateľ opakovane žiada uchádzača o jednoznačné a úplné vysvetlenie ponuky v zmysle žiadosti o vysvetlenie ponuky, zo dňa 10.10.2025.

Verejným obstarávateľom požadované doplnené doklady/dokumenty v rámci vysvetlenia ponuky je potrebné predložiť do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, prostredníctvom komunikácie systému Josephine.

Ponuka uchádzača, ktorá nespĺní požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky bude vylúčená z verejného obstarávania v zmysle § 53 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Uchádzač prostredníctvom komunikačného rozhrania IS Josephine požiadal verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na doručenie odpovede k žiadosti o vysvetlenie ponuky (2) na 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ žiadosti uchádzača vyhovel. Uchádzač v lehote určenej komisiou verejného obstarávateľa, dňa 17.11.2025 predložil vysvetlenie ponuky.

III. Záver:

Komisia bude pokračovať v hodnotení ponuky uchádzača.

IV. Prílohy:

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie zo dňa 9.10.2025, 9.11.2025

Prítomní členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu podpisujú v slobodnej vôli a s obsahom zápisnice súhlasia v plnej miere, čo potvrdzujú svojim podpisom.


MUDr. Henrieta Blašková ..

MUDr. Ľubomír Demský ..

MUDr. Vincent Greššák ..

MUDr. Alena Rolková ..

Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M ..

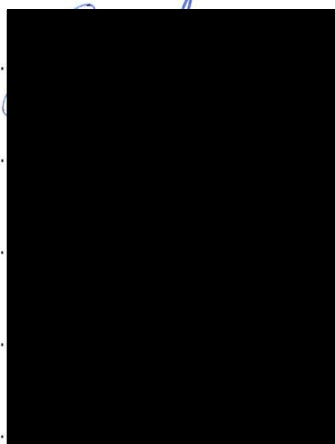

V Košiciach, dňa 17.11..2025



Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2025-24-NZ-POO

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie
zo dňa 9.10.2025

Predmet zákazky :	Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
Vyhlásenie verejného obstarávania :	Ú. v. EÚ OJ S 59/2025 č. 190739-2025 zo dňa 25.3.2025 VVO č. 174/2025 zo dňa 26.3.2025 pod označením 5689 - MST
Postup verejného obstarávania:	verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO
Zákazka z hľadiska limitu:	nadlimitná zákazka
Predkladanie ponúk:	elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote do 14.05.2025 do 12:00:00 hod.
Druh zákazky:	tovar
Miesto konania :	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Termín otvárania ponúk:	14.05.2025 o 12:30 hod.
Názov projektu:	Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj 128 slice – Rastislavova 43
Kód projektu:	11/02-21-V11-000171

I. Členovia komisie v zmysle § 51 ZVO v priebehu procesu hodnotenia ponúk a vykonaných zmien v zložení komisie:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. MUDr. Henrieta Blašková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 2. MUDr. Ľubomír Demský | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 3. MUDr. Vincent Greššák | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 4. MUDr. Alena Rolková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 5. Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M | - člen bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant verejného obstarávania (od 27.8.2025) |

MUDr. Henrieta Blašková

MUDr. Ľubomír Demský

MUDr. Vincent Greššák

MUDr. Alena Rolková

Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M

V Košiciach, dňa 09.10.2025



Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2025-24-NZ-POO

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie
zo dňa 9.11.2025

Predmet zákazky :	Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
Vyhlasenie verejného obstarávania :	Ú. v. EÚ OJ S 59/2025 č. 190739-2025 zo dňa 25.3.2025 VVO č. 174/2025 zo dňa 26.3.2025 pod označením 5689 - MST
Postup verejného obstarávania:	verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO
Zákazka z hľadiska limitu:	nadlimitná zákazka
Predkladanie ponúk:	elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote do 14.05.2025 do 12:00:00 hod.
Druh zákazky:	tovar
Miesto konania :	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Termín otvárania ponúk:	14.05.2025 o 12:30 hod.
Názov projektu:	Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj 128 slice – Rastislavova 43
Kód projektu:	11/02-21-V11-000171

I. Členovia komisie v zmysle § 51 ZVO v priebehu procesu hodnotenia ponúk a vykonaných zmien v zložení komisie:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. MUDr. Henrieta Blašková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 2. MUDr. Ľubomír Demský | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 3. MUDr. Vincent Greššák | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 4. MUDr. Alena Rolková | - člen s právom vyhodnocovať ponuky |
| 5. Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M | - člen bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant verejného obstarávania (od 27.08.2025) |

MUDr. Henrieta Blašková

MUDr. Ľubomír Demský

MUDr. Vincent Greššák

MUDr. Alena Rolková

Ing. Jana Lesayová, MPH, LL.M

V Košiciach, dňa 09.11.2025