

Preberací protokol

Projekt:	Artis Pheno – VUSCH Košice		
Zmluva/objednávka č:	Kúpna zmluva VUSCH č. 27-2019-KZ (H/19/035)	Zo dňa:	27.02.2019

Kupujúci:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.		
Adresa sídla:	Ondavská 8 040 11 Košice		
Predávajúci:			
Adresa sídla:	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		

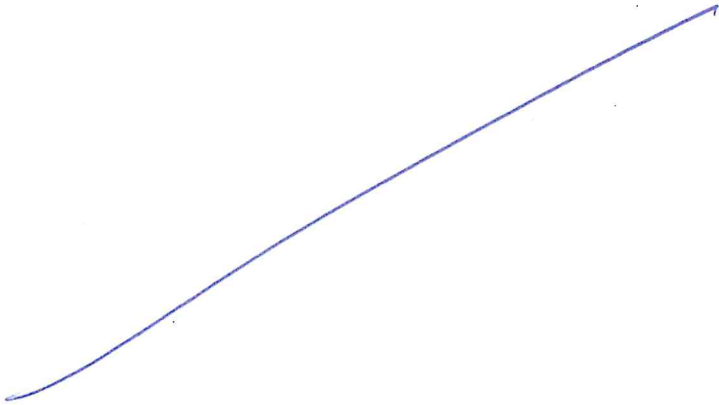
Predmet dodávky:	Jednorovinnový multi-osový RTG zobrazovací systém Artis Pheno výrobné číslo: 164194 spolu s USG prístrojom Acuson SC2000 výrobné číslo: 404618 podľa technickej špecifikácie prílohy č 1. Súčasťou dodávky je doprava zariadenia do miesta plnenia, vyloženie, vybalenie a likvidácia obalov, inštalácia prístroja, uvedenie prístroja do prevádzky, odskúšanie zariadenia, zaškolenie zamestnancov na obsluhu, elektrickú revíziu pripojenia a preberáciu škúšku. Krajina pôvodu: DE AL: N ECCN: N Colná nomenklatúra: 90221400 Tieto položky podliehajú kontrole vládou USA (pokiaľ sú označené "ECCN" nerovné "N") a ich vývoz je povolený iba do krajiny konečného určenia na použitie tu uvedeným konečným príjemcom alebo konečným užívateľom. Bez predchádzajúceho súhlasu vlády USA alebo pokiaľ to nedovoľujú americké zákony alebo predpisy, nesmú byť či už v pôvodnej forme alebo po zapracovaní do iných položiek, ďalej predané, prevedené alebo premiestnené do inej krajiny alebo inej osobe ako je oprávnený konečný príjemca alebo konečný užívateľ. Položky s označením "AL" nerovné "N" podliehajú európskemu / národnému vývoznému povoleniu. Tovary s označením "EKN" nerovné "N" pri vývoze podliehajú národnému vývoznému povoleniu. Položky bez označenia alebo s označením "AL:N" / "EKN:N" / "ECCN:N" alebo s označením "AL:9X9999" / "EKN:9X9999" / "ECCN:9X9999" môžu podliehať povoleniu príslušných úradov v závislosti od ich konečného použitia alebo miesta určenia.
------------------	--

Dátum odovzdania a prevzatia:	04.08.2019
-------------------------------	------------

Miesto dodania:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 040 11 Košice
-----------------	---

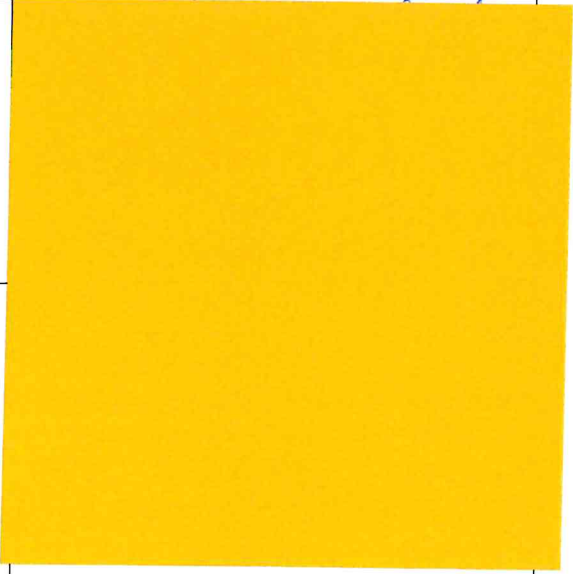
K prístroju bola dodaná nasledovná dokumentácia:	• EC Declaration of conformity – prehlásenie o zhode (CE) • Protokol o zaškolení obsluhujúceho personálu • Elektrická revízia zariadenia • Preberacia skúška zariadenia • Návod na obsluhu v slovenskom jazyku (umiestnený na pracovisku v písomnej forme a na CD)
--	--

Vyjadrenie zákazníka:	Predmet dodávky bol akceptovaný bez výhrad. Prístroj je plne funkčný.
-----------------------	--

Na dokončenie zostáva / námietky / pripomienky:	
---	--

Schvaľovacia doložka:	Na základe tohto preberacieho protokolu je spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o. oprávnená fakturovať sumu v zmysle Kúpnej zmluvy č. VUSCH č. 27-2019-KZ (H/19/035) zo dňa 27.02.2019
-----------------------	--

Záruka:	Dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť 24 mesačná záručná doba predmetu dodávky. Tento protokol zároveň slúži ako záručný list.
---------	---

Dátum	Meno	Spoločnosť	Podpis
07/08/2019	Dr. František Šolc / y. Haničan Albert KOUPČ JANĽA NOVÁ	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	
07/08/2019	ŠVÁB	Siemens Healthcare s.r.o.	