



**TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.**

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika



Skúšobňa TSÚ - Skúšobňa strojov a výrobných zariadení

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

e-mail: mario.zemko@tsu.sk

www.tsu.sk

POM č.: [redacted]

Strana: 1 / 5
Príloha: -

PROTOKOL O MERANÍ č.: [redacted] / A




Názov merania: Meranie emisnej hladiny akustického tlaku
Predmet merania: Germicídny žiarič PROLUX G®
Type: 30WASPH 02 A
Výrobné číslo: [redacted]
Menovité údaje: 2 [redacted]
Výrobca: Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, Slovakia
Objednávateľ: Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, Slovakia
Číslo objednávky: [redacted]
Miesto merania: Bezdozvuková skúšobná miestnosť, TSÚ Piešťany, š.p.
Metóda merania: STN EN ISO 11201
Dátum merania: 20-05-2019
Dátum vydania: 24-05-2019
Rozdeľovník: 1. – objednávateľ
2. – TSÚ Piešťany, š.p.

Meral a protokol [redacted]
vyhotovil: skúšobný technik


Kontroloval [redacted]
a schválil: vedúci skúšobne

Výsledky meraní uvedené v tomto protokole sa týkajú len predmetu merania a nenahrádzajú iné dokumenty, ktoré sú požadované orgánmi štátneho dozoru a podľa iných špecifických predpisov. Protokol o meraní môže byť reprodukováný alebo publikovaný len v celku, po častiach len s písomným súhlasom skúšobne TSÚ.
COPYRIGHT © TSÚ Piešťany, š.p.



Meracie prístroje

Me
Me
Me
Mik
Mik
Mik
Fre
Aku
Mu
Reg
Dat
vlni

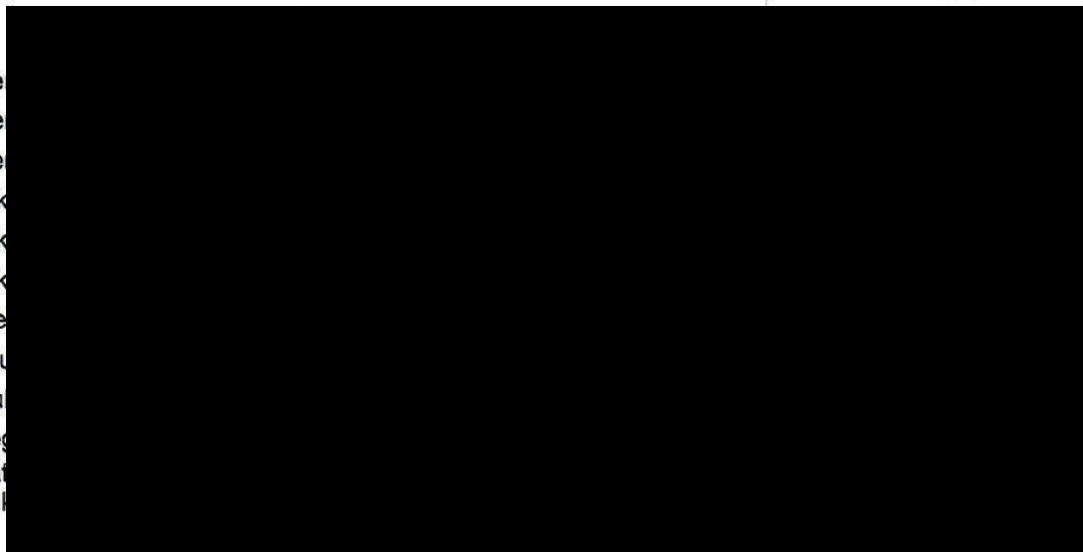

P
T akreditovaného metrologického laboratória


Metóda merania

S
H
V



nisných
ujúcom

Podmienky merania


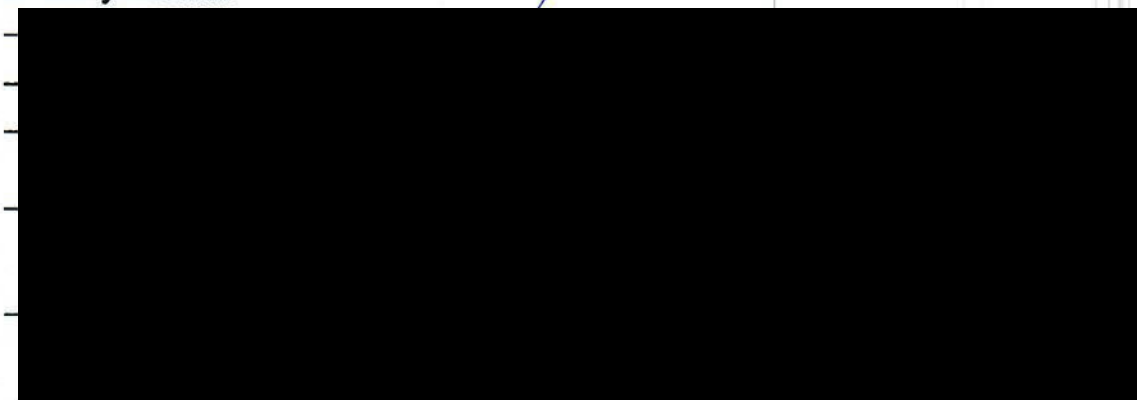




osti.

5 m.

nutí

Obrázok 1 – Umiestnenie skúšobnej vzorky

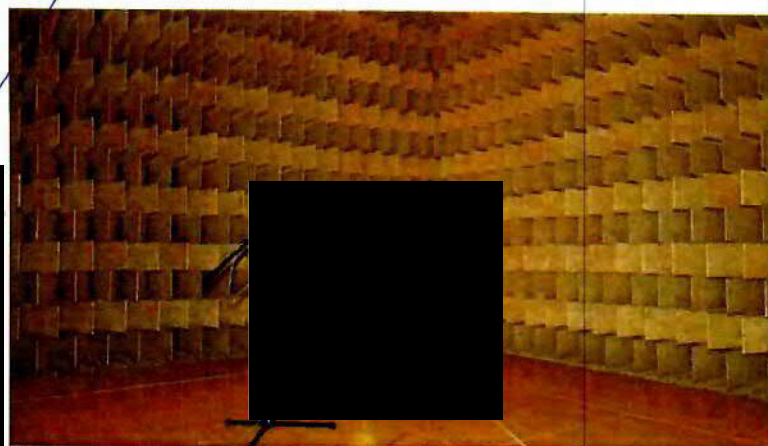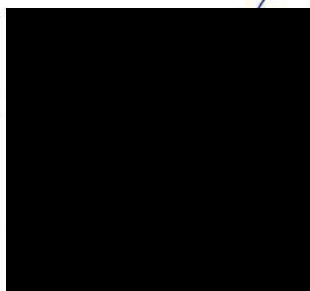

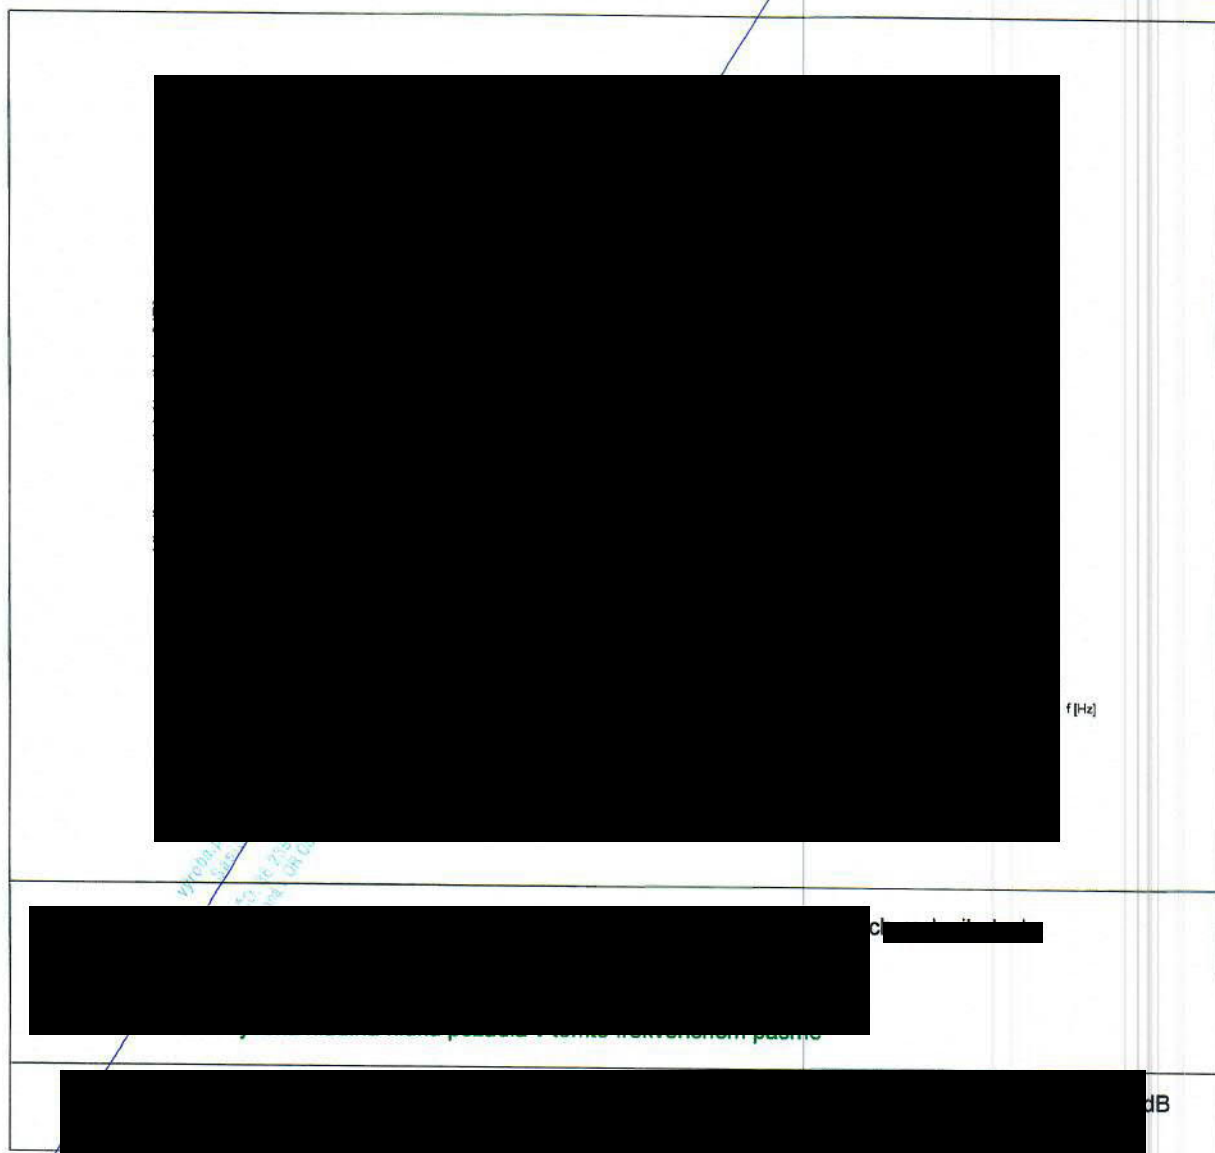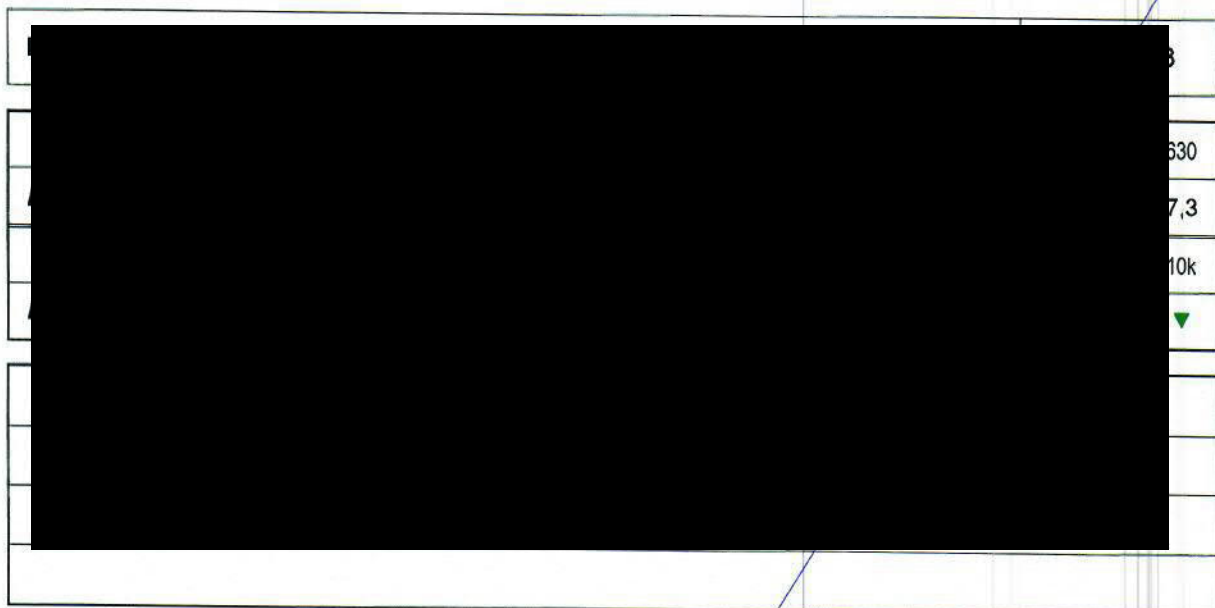

koniec protokolu o merani



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy.

ISO 9001: 2015

Predmet certifikácie

VÝROBA, PREDAJ A SERVIS GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G[®]

Pôvodný dátum schválenia: **03.07.2015**

Začiatok recertifikačného cyklu: **02.07.2018**

Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **01.07.2021**

Verzia: **1**

Dátum revízie: **02.07.2018**

Adresa certifikačného orgánu: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Lokálna adresa: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovenská republika**



0008

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.
Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: + 421 [redacted]

BUREAU VERITAS
Certification



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001: 2015

Scope of certification

MANUFACTURE, SALE AND SERVICING OF GERMICIDAL EMITTERS PROLUX G®

Original cycle start date: **03 JULY 2015**

Recertification cycle start date: **02 JULY 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **01 JULY 2021**

Version: **1**

Revision date: **02 JULY 2018**

Certification body address: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Local office: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovak Republic**



0008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 4 [REDACTED]



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy.

ISO 14001: 2015

Predmet certifikácie

VÝROBA, PREDAJ A SERVIS GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®

Pôvodný dátum schválenia: **03.07.2015**

Začiatok recertifikačného cyklu: **02.07.2018**

Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **01.07.2021**

[Redacted]

Verzia: **1**

Dátum revízie: **02.07.2018**

[Redacted]
Adresa certifikovaného orgánu: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Lokálna adresa: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovenská republika**



0008

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.

Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: + 421 **[Redacted]**

BUREAU VERITAS
Certification



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001: 2015

Scope of certification

MANUFACTURE, SALE AND SERVICING OF GERMICIDAL EMITTERS PROLUX G[®]

Original cycle start date: **03 JULY 2015**

Recertification cycle start date: **02 JULY 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **01 JULY 2021**

Version: **1**

Revision date: **02 JULY 2018**

Certification body address: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Local office: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovak Republic**



0008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 4 [REDACTED]



**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Trnavská cesta 52
P. O. BOX 45
826 45 Bratislava

ODBOR
OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK




PROTOKOL O SKÚŠKACH

v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazník:		Strana: 1/5
		Kód vzoriek:
Názov vzorky: Germicídne žiarenie a PROLUX		
Dátum vykonania skúšky: 26.4.2019	Skúšku vykonal: Ing. Ľudmila Juchová, Miroslava Chrenková	Prítomný pri meraní: Ing. Ivan Ondrejka
Skúška: Meranie UV žiarenia	Kód ŠPP:	A

A - akreditovaná skúška N - neakreditovaná skúška

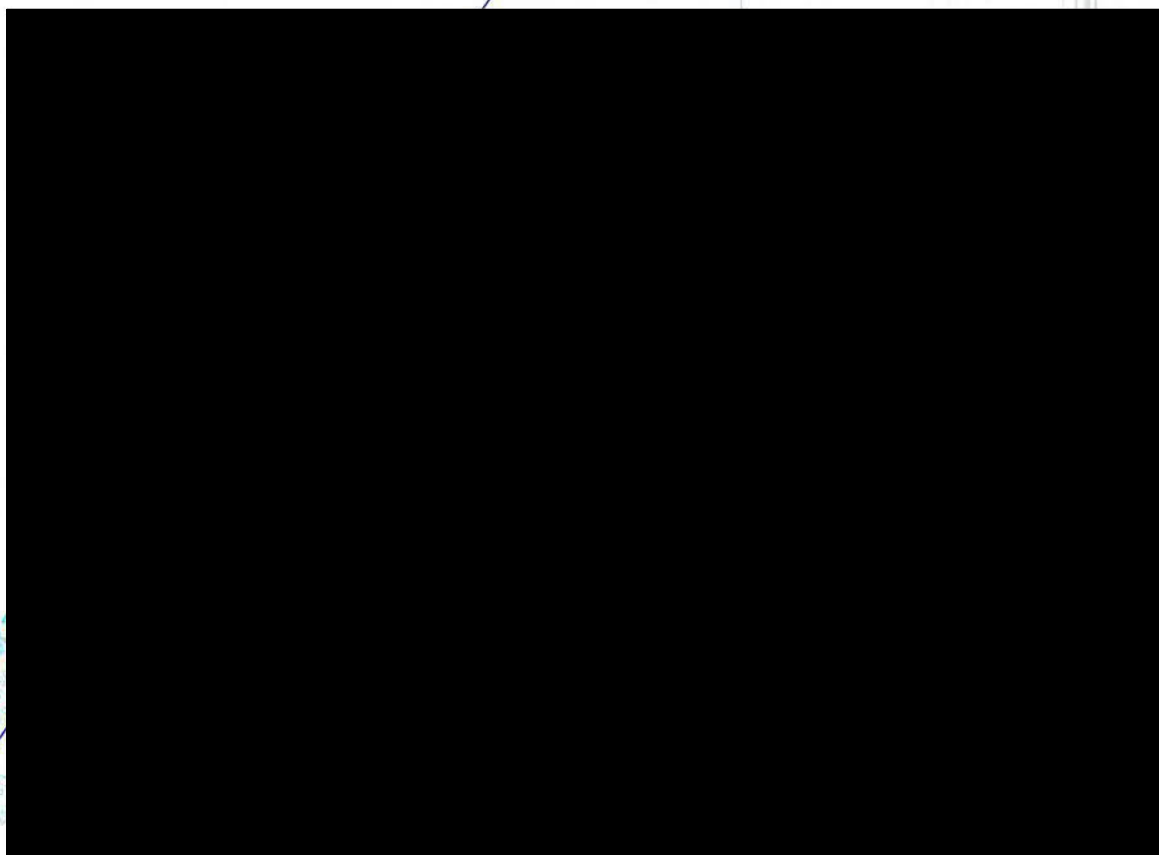

Nex
výroba podľa
S. n. č. 1/2019
2. 10. 2019

un-

avom,
ie dňa
obcom

avskej



[REDACTED]

[REDACTED]

Výsledky merania:

[REDACTED]

1/23
23/03/2023



Tab. 1

Kód

Ro
* r
Uz
mie

Otv





časový záznam testu

mikro Wizen2

čas

mikro Wizen2


Time

00 Time

Názory a interpretácie výsledkov:



ých
iou




[REDACTED]

[REDACTED]

Kopírovanie časti protokolu nie je dovolené. Prenos čiastkových údajov z Protokolu o skúškach Úradu verejného

[REDACTED]

[REDACTED]



CERTIFIKÁT ZHODY

č. 1 Výrobca: Výrobok: **Germicídne žiariče PROLUX G®**Typ: **WA**

Špecifikácia: varianty výrobku sú špecifikované na zadnej strane certifikátu

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (smerníc ES/EÚ nového prístupu) v ich platnom znení:

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ekv. Smernica 2014/35/EÚ)

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (ekv. Smernica 2014/30/EÚ)

Harmonizované normy použité pre posúdenie zhody:

STN EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2015 (ekv. EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2014)


STN EN 60335-2-65:2005/A1:2009/A11:2013 (ekv. EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012)

STN EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (ekv. EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)

STN EN 61000-6-1:2007 (ekv. EN 61000-6-1:2007)

STN EN 61000-3-2:2015 (ekv. EN 61000-3-2:2014)

STN EN 61000-3-3:2014 (ekv. EN 61000-3-3:2013)

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č.  dňa 20.08.2019.



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES/EÚ

Dátum vydania: 21.08.2019


Platnosť do: 20.08.2022

Vydanie: 1





Vedúci certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky

Špecifikácia – varianty výrobku



Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

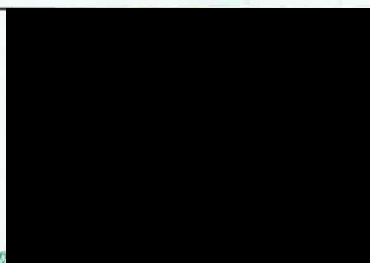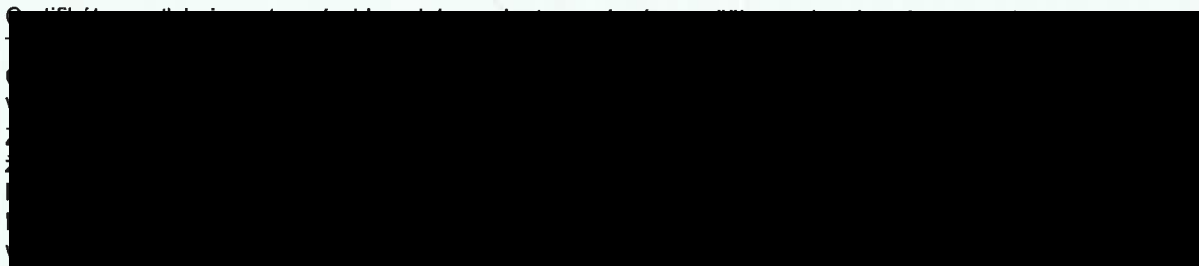

Germicídny žiarič PROLUX G[®] M30WA

katalógový list

Dezinfekcia vzduchu - použitie:



Technické parametre: PROLUX G[®] M30WA (2x15 W)




PROLUX G M30WA

Návod na použitie

Germicídneho žiariča PROLUX G[®] M30WA


Dezinfekcia vzduchu - použitie:

za
je
pô
rý
U
ot
ic
m
G
m

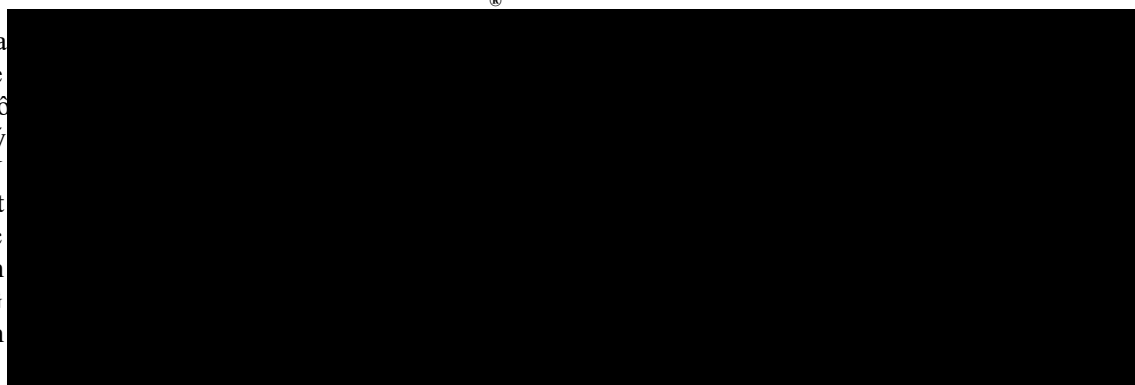


Montáž germicídneho žiariča:


e
s
z
p
d
n
p
ž
p
n
k
p
v
v





o
oj
ý
ý
a
ta
ší
iu
h
e
n
C

[illegible]

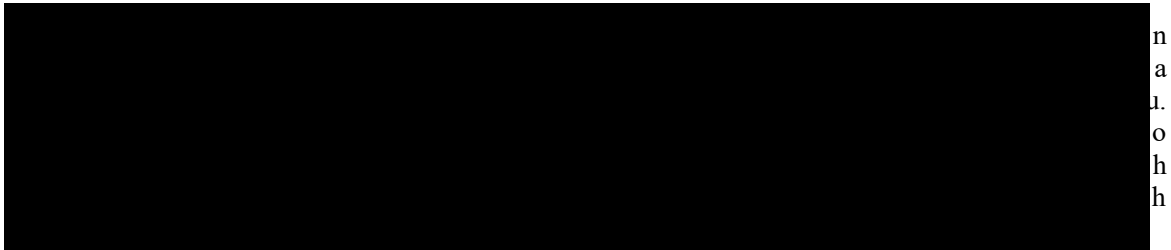


n
a
l.
o
h
h




Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie



Údržba vnútra žiariča a zdrojov ultrafialového žiarenia:



Údržba povrchu germicídneho žiariča:

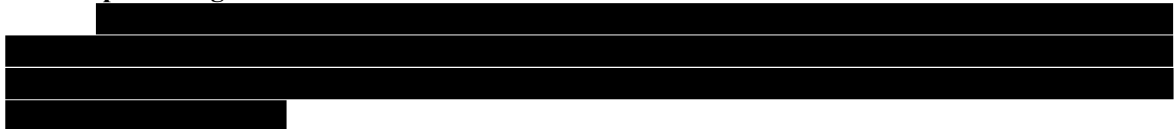

Životnosť germicídneho žiariča:





Likvidácia germicídneho žiariča po jeho životnosti:

[REDACTED]



Výstrahy:

[REDACTED]

zaťaženia.



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA!

Vyžarovanie germicídneho žiariča je škodlivé pre oči a pokožku.



Vyžarovanie UVC žiarenia z germicídneho žiariča:

[REDACTED]



Elektrické krytie:

[REDACTED]

Značenie a grafické symboly

A large black rectangular redaction box covers the majority of the page, obscuring all text and graphics. Only the left margin, containing a vertical list of symbols and the word 'R', and the top right corner, containing the letter 'a', are visible.

Technické parametre: PROLUX G® M30WA

Napájanie:

[REDACTED]



Záručná doba:

[REDACTED] v (viď záručné podmienky v záručnom liste).



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:	Medic Partners, s.r.o
Sídlo uchádzača:	Svätovojtešská 7, 831 03 Bratislava
IČO:	51 207 281
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Mgr. Ján Žurek
IČ DPH:	SK21 20641017
Názov banky:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	[REDACTED]
Telefónne číslo:	+42 [REDACTED]
E-mailová adresa:	jan.zurek@medicpartners.sk

Predmet zákazky: „Germicídny žiarič uzavretý“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	Výška DPH	Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Germicídny žiarič 30W uzavretý (za prítomnosti osôb) s ventilátorom, mobilný v celkovom odbernom množstve 40ks v súlade s opisom predmetu tejto výzvy.	2.629,20€ (20%)	15.776,40€

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky.

Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

Lehota dodania tovaru (v dňoch)*	15 dní
----------------------------------	--------

* Max. lehota dodania tovaru je 15 dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.

Som – Nie som platiteľom DPH (nehodí sa preškrtnite)

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude fakturovať.

V Bratislave, dňa 29.10.2020

Mgr. Ján Žurek

meno a priezvisko
podpis štatutárneho zástupcu,
pečiatka